


Microscop inversat automat cu camera CCD color si software



Data livrării: 29 Noiembrie 2010.


Punere în funcțiune și training: Bogdan Prejoianu, TECHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL, 29 Noiembrie 2010.

Training: 29 – 30 Noiembrie 2010.


I. Instalare

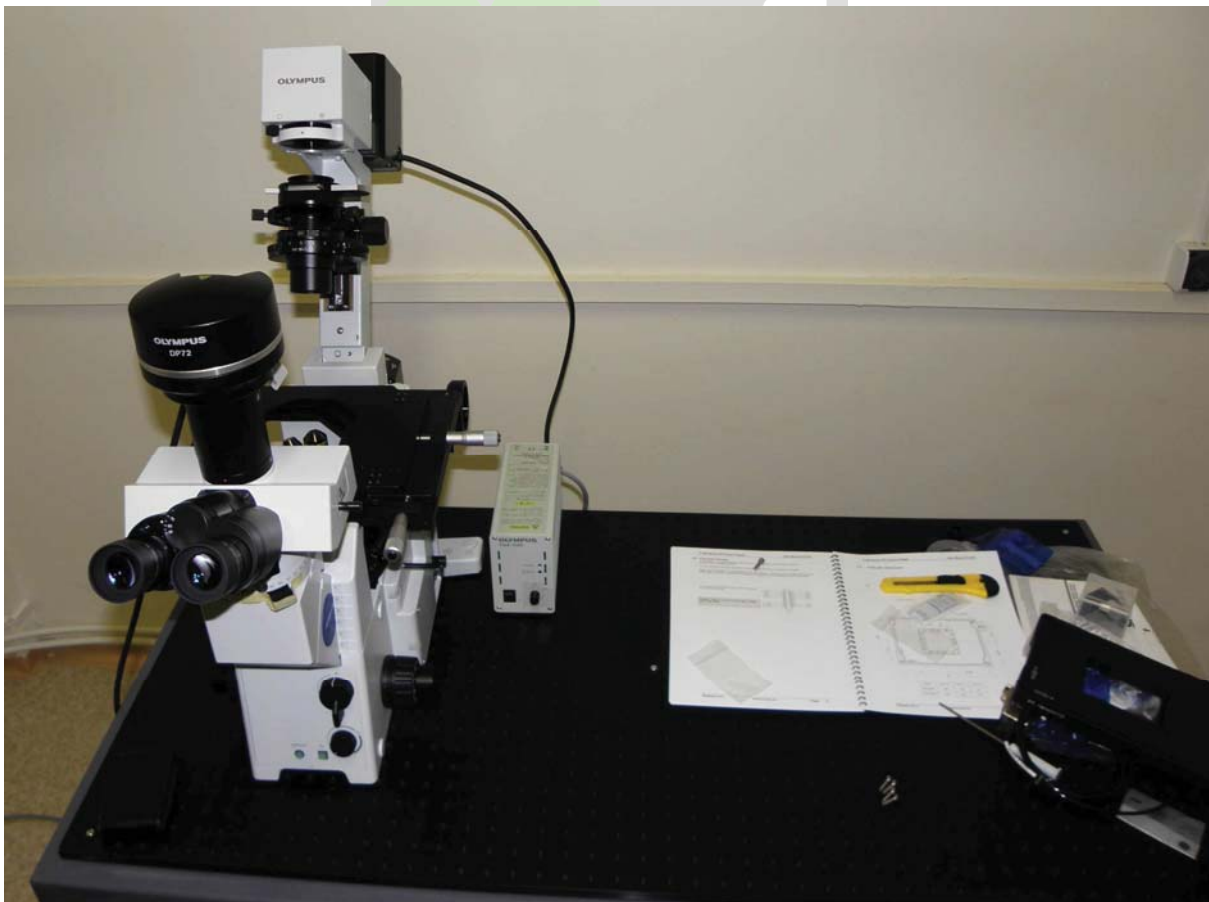

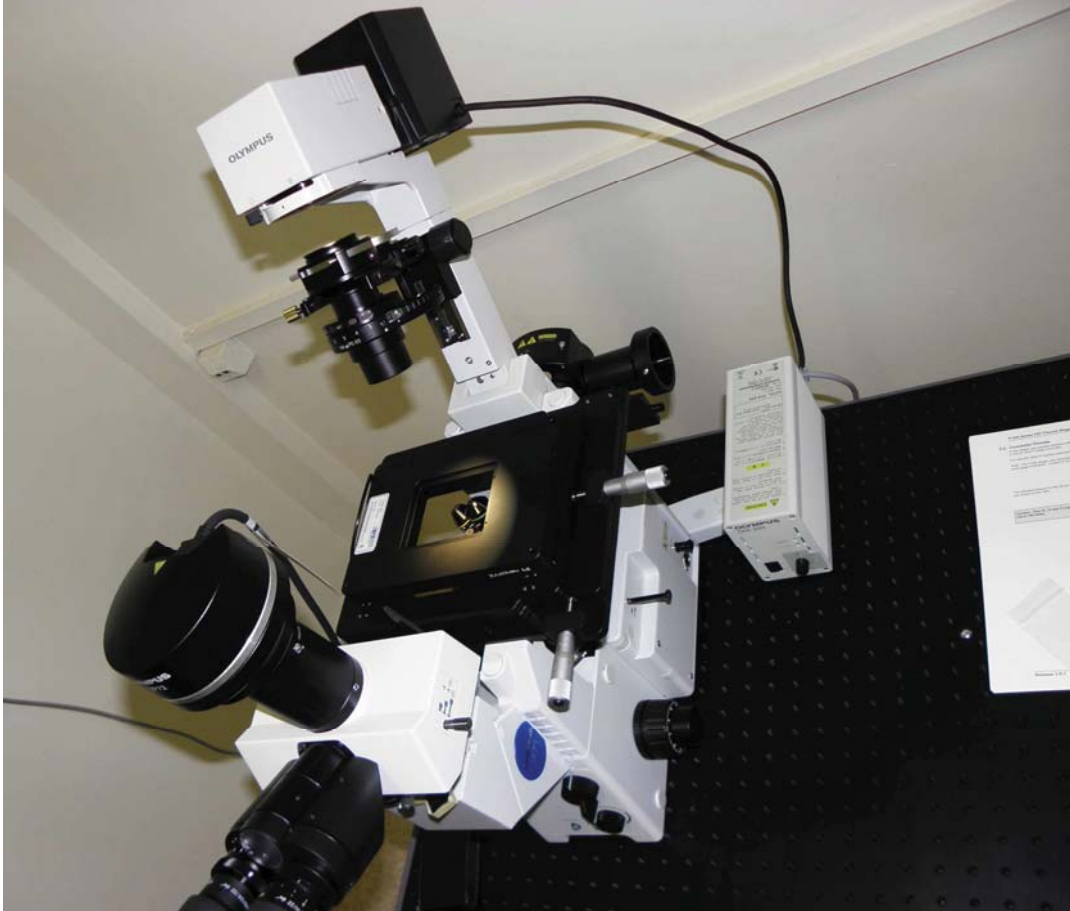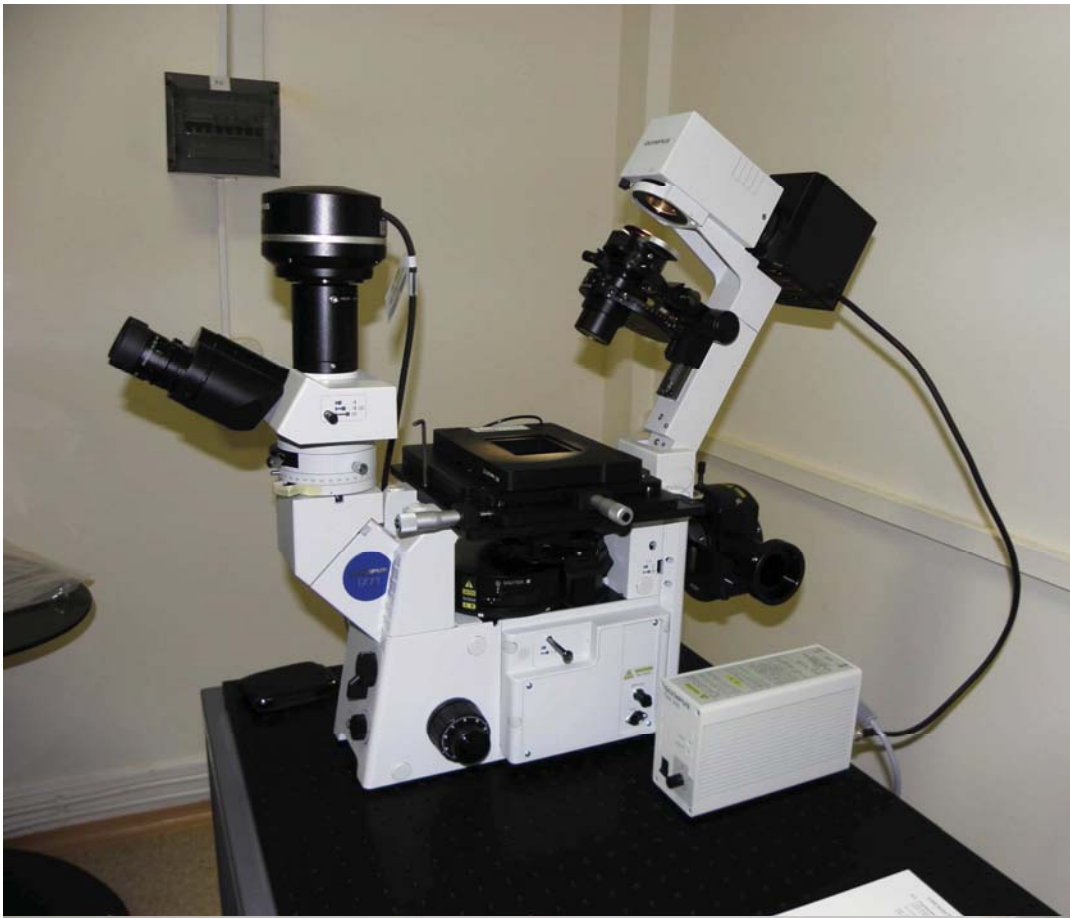

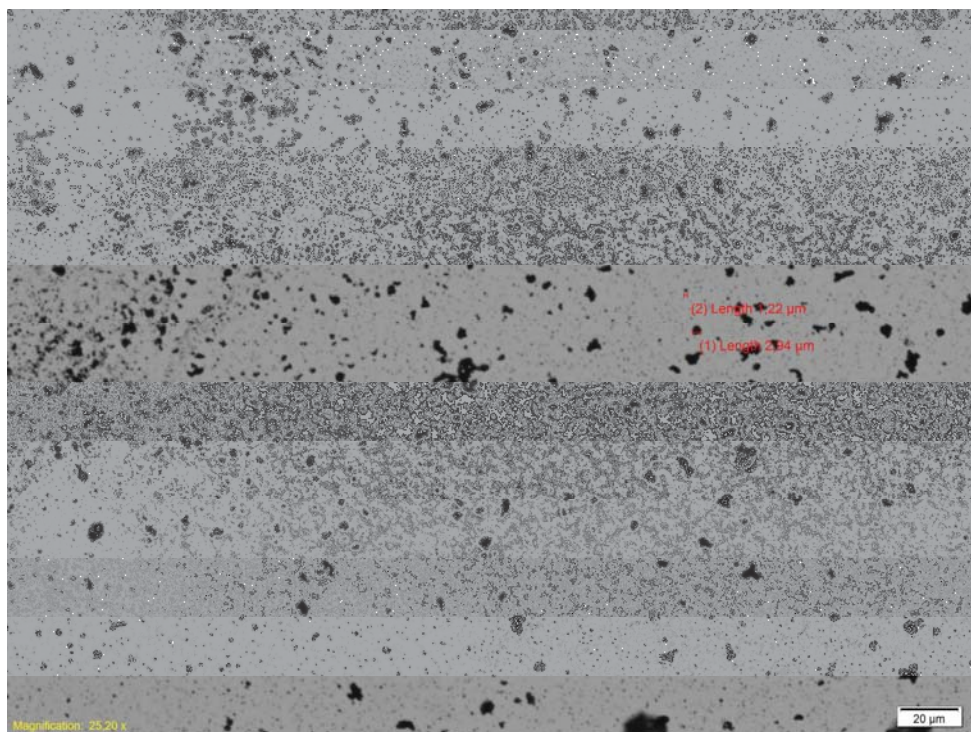


Nanoparticule de aur inregistrate cu obiectivul de 40x.

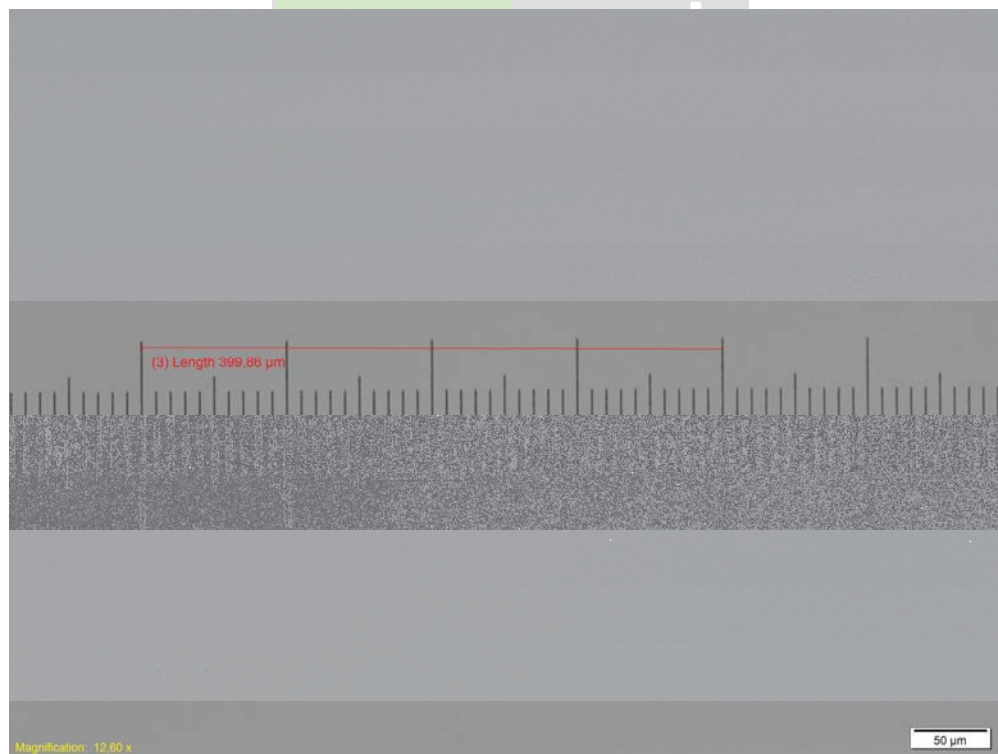


Lamela cu scala pentru calibrare, inregistrata cu obiectivul de 20x.




Celule de drojdie de bere (Yeast cells), inregistrata cu obiectivul de 40x.

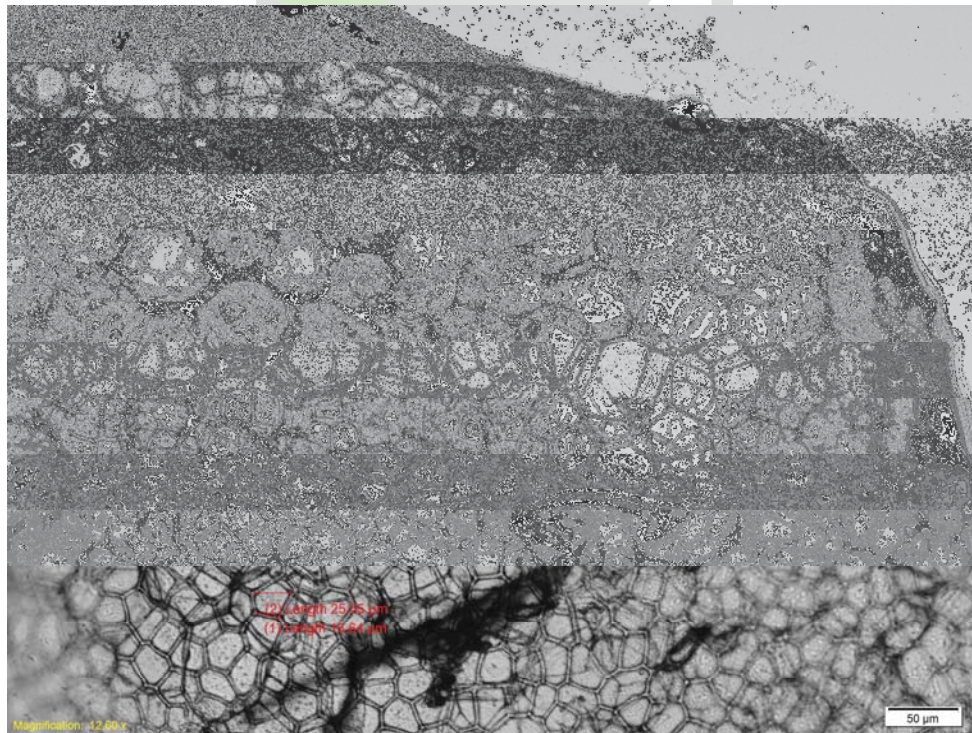


Tesut de planta, inregistrata cu obiectivul de 20x.

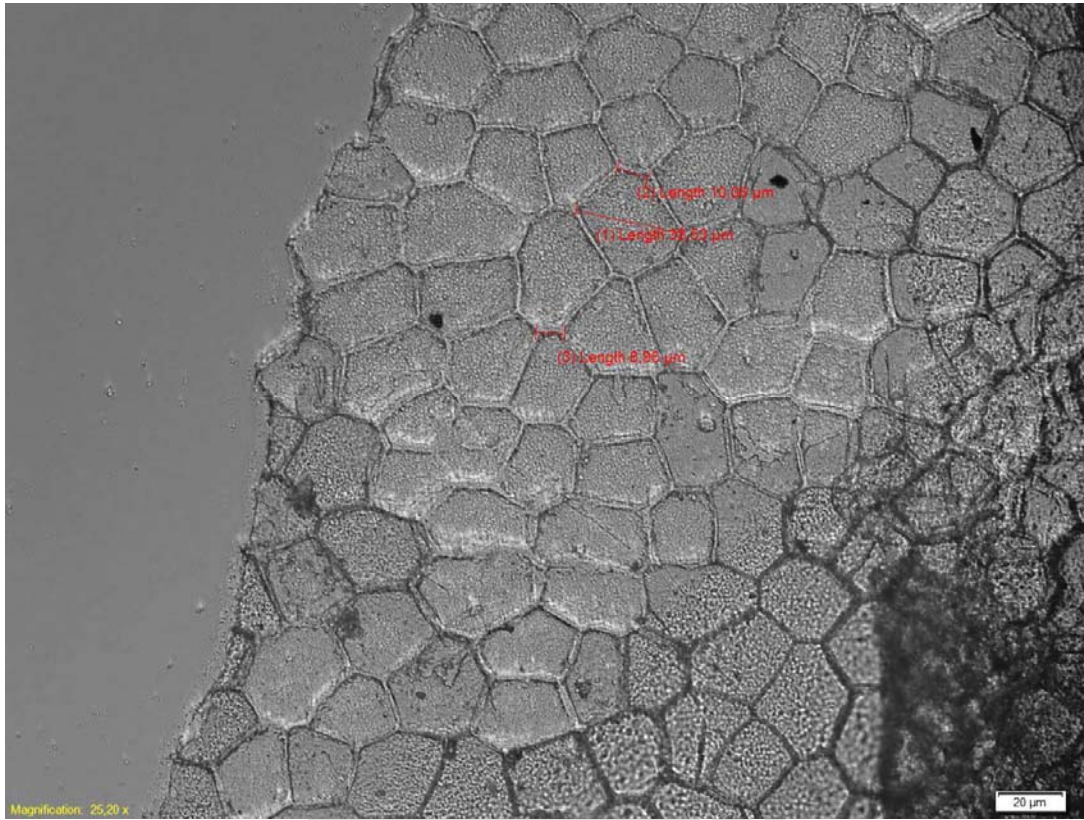

Tesut de planta, inregistrata cu obiectivul de 40x.

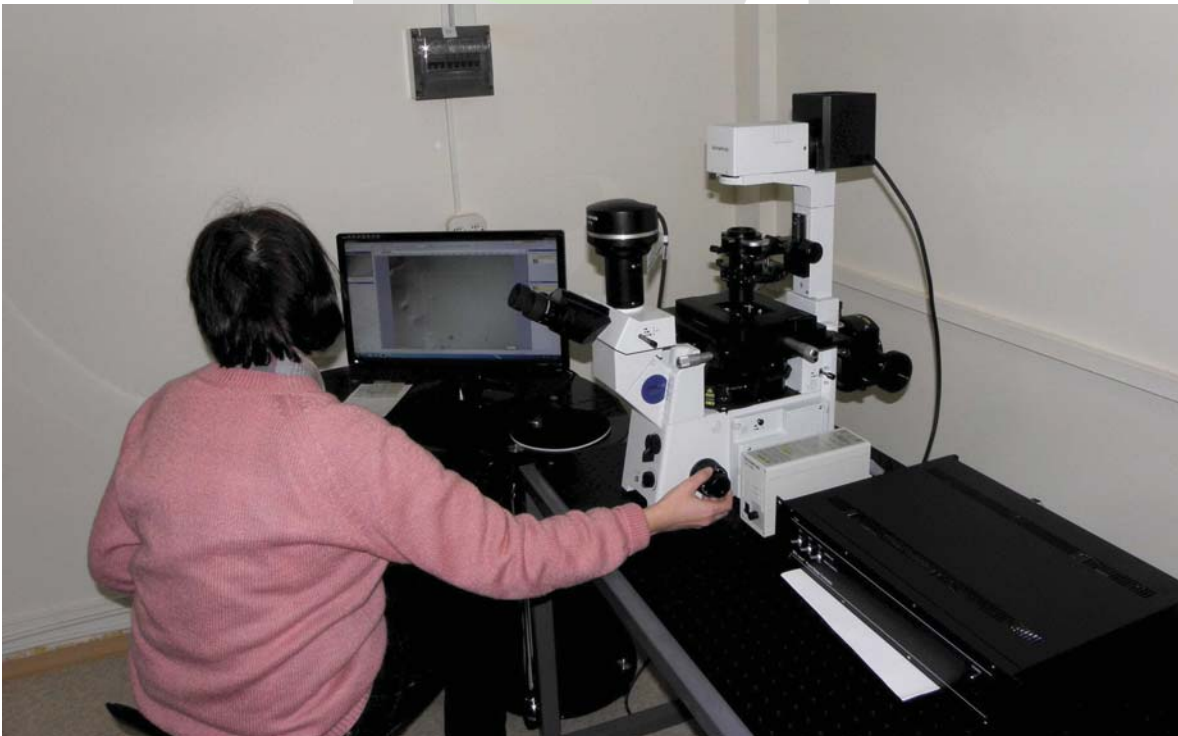

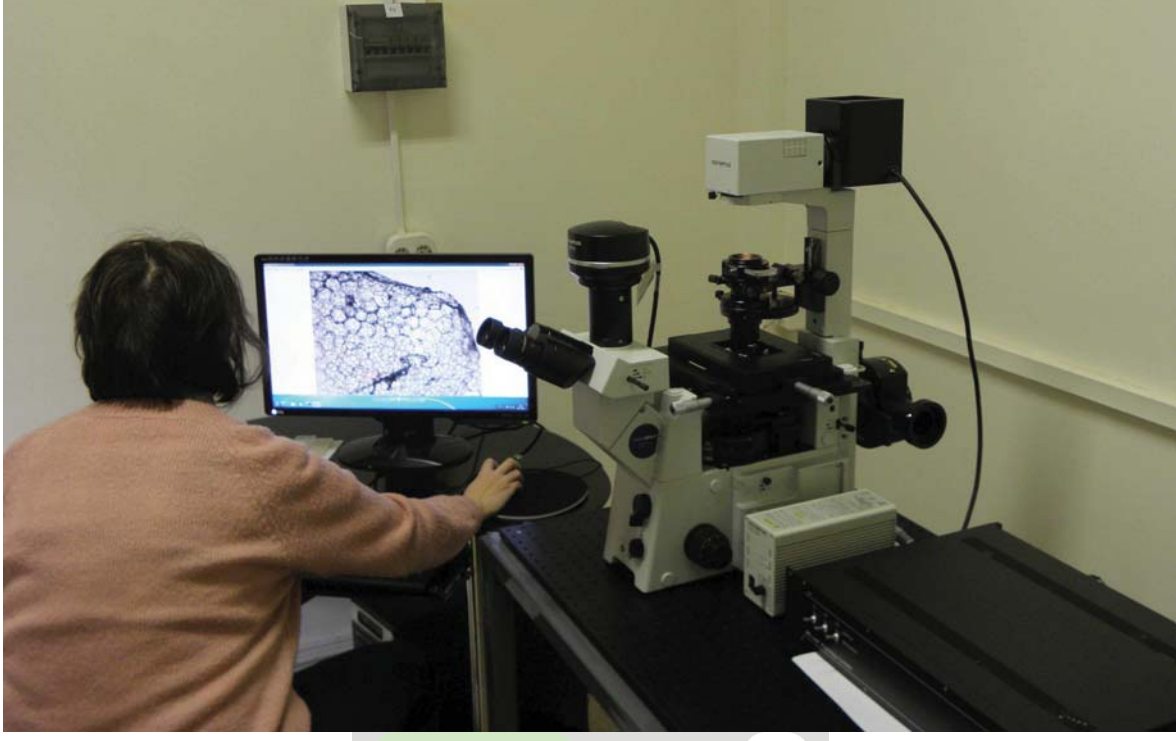

WIDEFMO

<http://www.itim-cj.ro>