



Analizor de spectru cu accesorii

Data livrării: 22 Octombrie 2010.

Punere în funcțiune și training: Radu Mateescu, COMTEST SRL, 22 –23 Octombrie 2010 – 23 ; 26 Noiembrie 2010.

Punerea în funcțiune





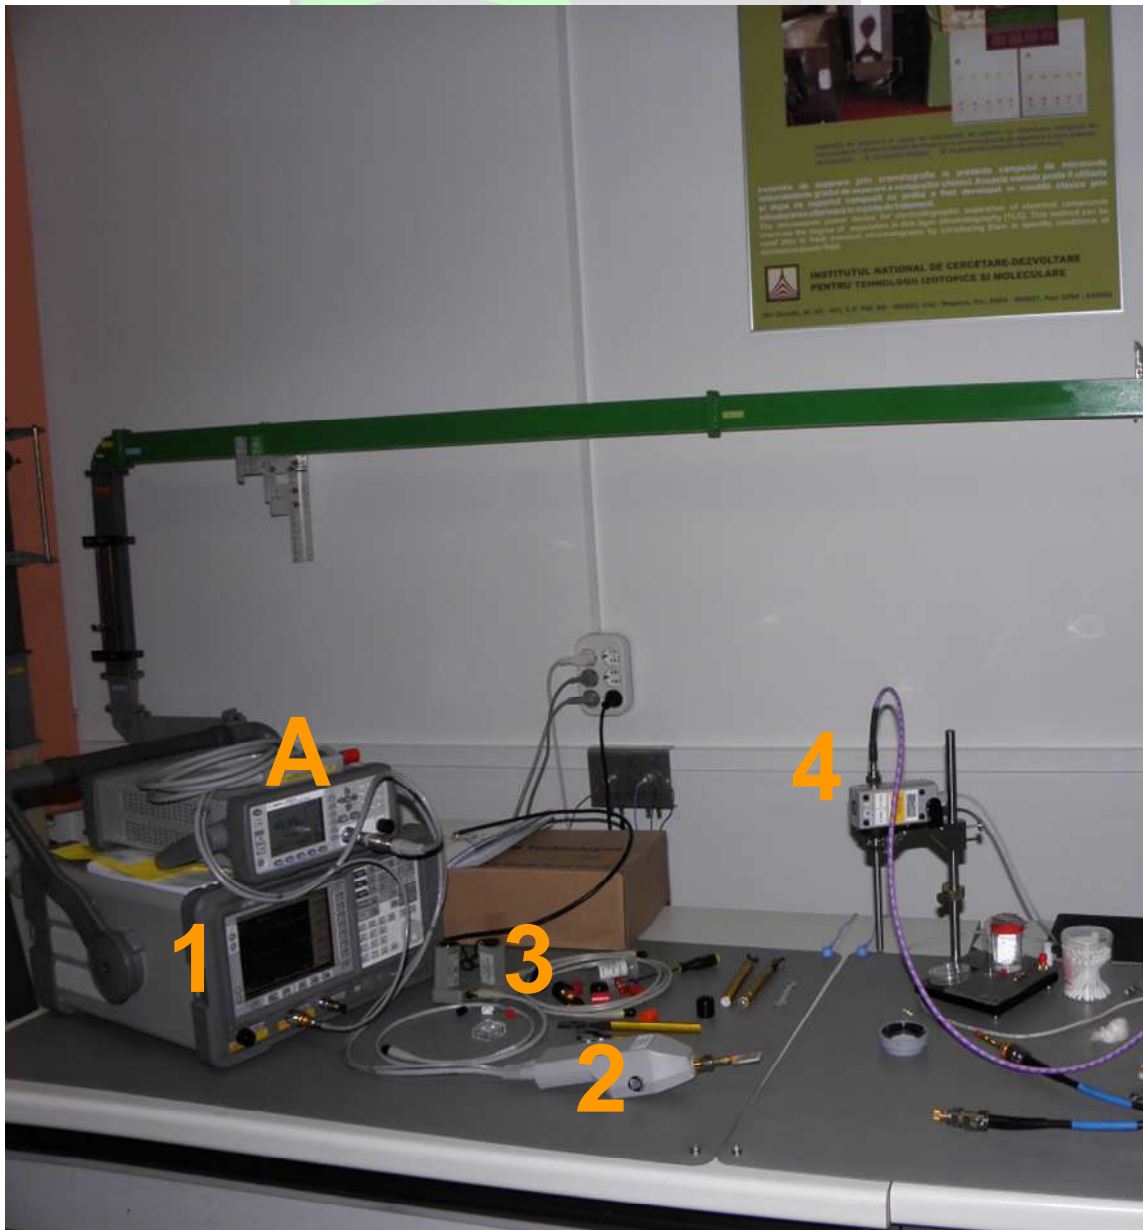


Figura 3. Unitatea de baza a analizorului de spectru (1) sonda pentru masurarea de prezie a puterii de intrare (2) conectata si la un powermetru existent (A), mixerele de inalta frecventa (3) si modulul de calibrare E-Cal (4).

Testarea accesoriilor pentru masurarea constantei dielectrice.

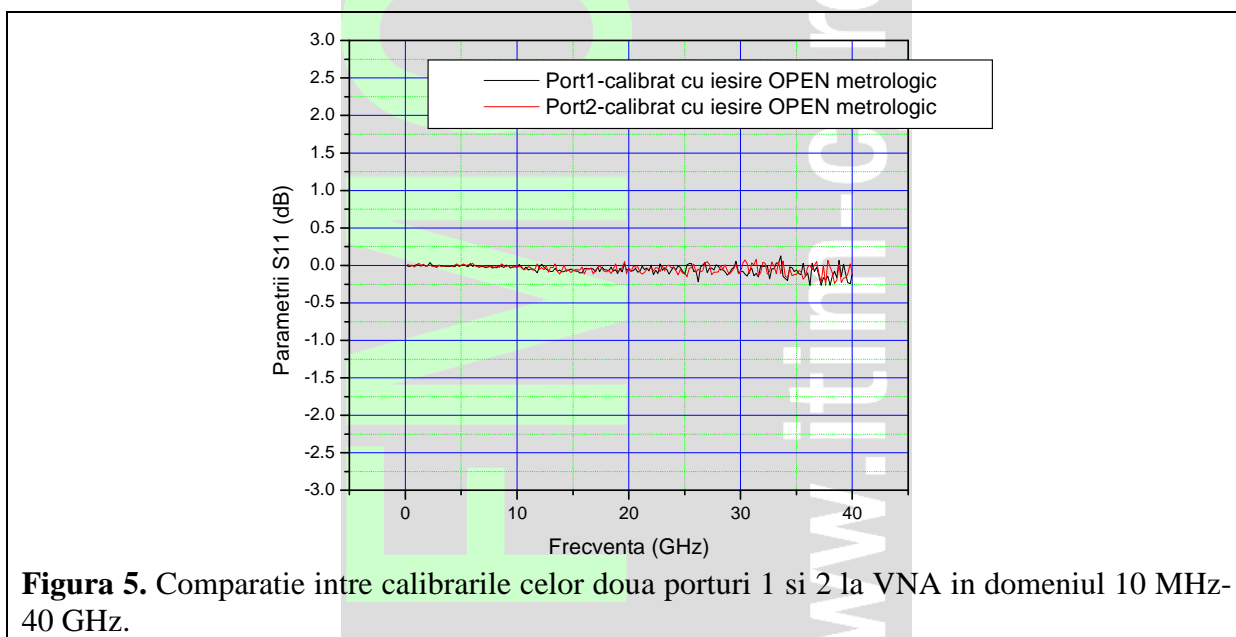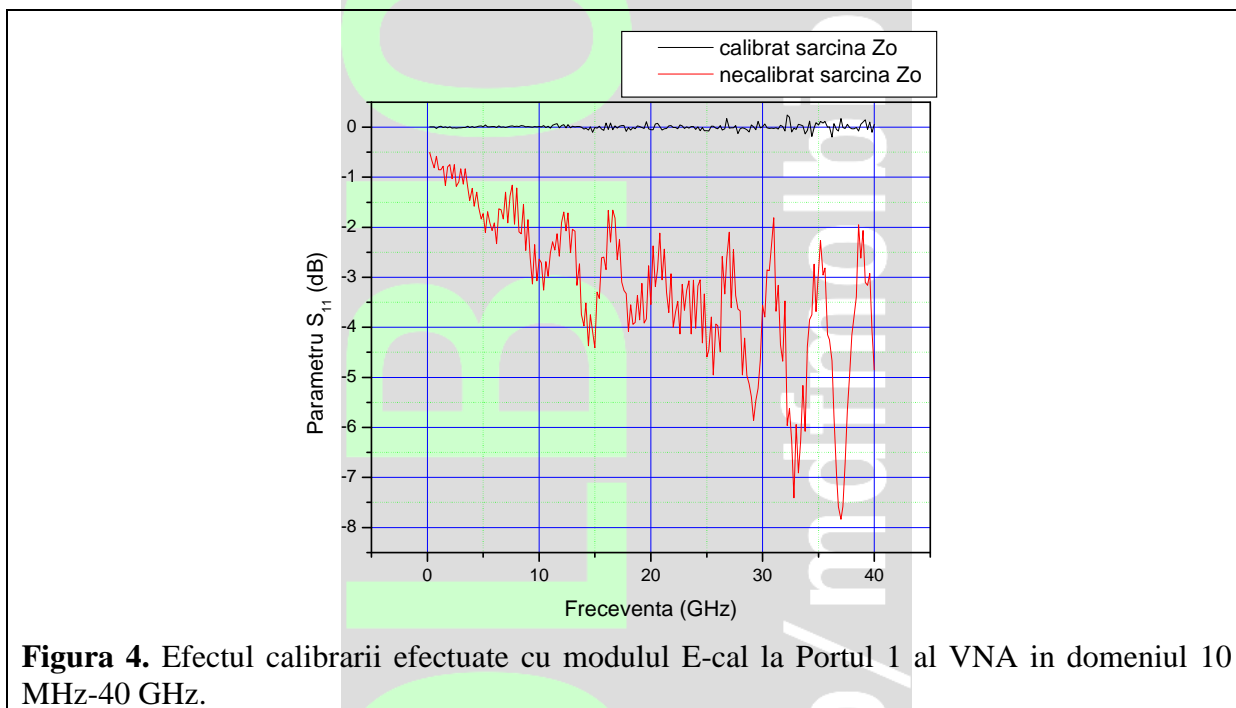

Rezultatele testelor de calibrare corespund specificatilor tehnice.